

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГБНУ ВИЛАР, академик РАН


Н.И. Сидельников
« 29 / 12 » 2025 г.



**Сведения о загрузке оборудования,
используемого при работе с уникальной научной установкой (УНУ)
«Биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР» ***


Обозначение	Наименование оборудования и контрольно-измерительных приборов	Количество	Производитель	Расчетное время работы, час	Фактическое время работы оборудования, час.*	
					всего	в т. ч. в интересах третьих лиц
1	2	3	4	5	6	7
2	Микроскоп стереоскопический, в комплекте: -цифровая окулярная USB камера;	1	Россия, Альтами БИО-2 LED, Санкт-Петербург	1972	1775	319,5

	-программное обеспечение Altami Studio					
2	Автоклав, стерилизатор паровой электрический Тип ВК-75	1	Россия, ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г. Тюмень	1972	1657	331,4
3	Весы лабораторные AF-R 220 CE	1	Россия	1972	1775	355
4	Спектрофотометр СФ-26 ЛОМО	1	Россия	1972	1578	284
5	Анализатор влажности ML-50	1	Япония, AND	1972	1775	319,5
6	Ламинарный бокс с горизонтальным потоком	1	Россия	1972	1775	319,5
7	Морозильная камера Вестфрост VT 327	1	Дания, VESTFROST	1972	1775	337
8	Термостат суховоздушный ТС-80М-2	1	Россия, ОАО «Медлабортехника»	1972	1775	319,5
9	Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	1	Россия, Смоленское СКТБ СПУ	1972	1657	248
10	Холодильник «Daewoo»	1	Корея	1972	1775	337
11	Микроскоп стереоскопический МикМед 5	1	Россия	1972	1657	298,3
12	Весы лабораторные электронные МВ 210-А	1	Россия, Сартогосм	1972	1657	314,8
13	Весы электронные ER-182 А	1	Япония, AND	1972	1578	315,6

14	Двухлучевой спектрофотометр с автоматической регистрацией, Shimadzu	1	Япония, Shimadzu	1972	1657	281,7
15	Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ.З	1	Россия, ООО «Кортек»	1972	1715	325,9
16	Микроцентрифуга настольная Sencom, 12 гнезд для насадок	1	Испания, SELECTA	1972	1578	331,4
17	Фотометр биохимический полуавтоматический, CLIMA MC-15	1	Испания, «RAL»	1972	1657	298,3
18	Хроматограф жидкостный Prominence-i	1	Япония, Shimadzu	1972	1715	343
19	Центрифуга лабораторная ЦЛМН Р 10-01	1	Россия, Элекон-М	1972	1657	314,8
20	УВИ-спектрофотометр CARY модель 100	1	США	1972	1715	325

* по состоянию на 29.12.2025 г.

Заведующий научно – организационным отделом,
кандидат фармацевтических наук

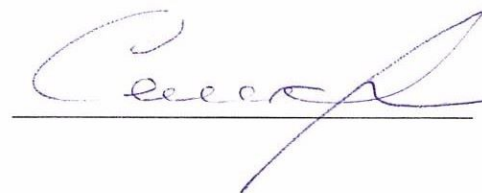

О.А. Семкина